

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、  
厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたく  
ご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白


記

■実施日 平成25年12月28日（土）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

| 案内書<br>掲載頁 | 項目コード<br>統一コード | 検査項目      | 変更箇所        | 新           | 現                                        | 備考                     |
|------------|----------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|
| 69         | 2267<br>5G090  | 抗セントロメア抗体 | 検査方法        | CLEIA       | EIA                                      | 測定委託先における<br>検査試薬変更のため |
|            |                |           | 基準値<br>(単位) | 10.0U/mL 未満 | 陰性 <10.0<br>判定保留 10.0≤、<16.0<br>陽性 ≥16.0 |                        |
|            |                |           | 単位          | U/mL        | なし (index値)                              |                        |
|            |                |           | 報告上限値       | 500U/mL 以上  | 300 以上                                   |                        |
|            |                |           | 報告下限値       | 2.0U/mL 未満  | 5.0 未満                                   |                        |
|            |                |           | 所要日数        | 4～5日        | 5～8日                                     |                        |

【新旧二法の相関】

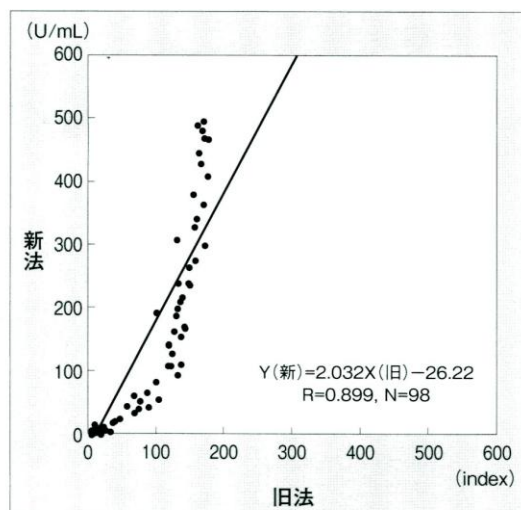

判定一致率

|    |    | 旧法 |      |    | 計  |
|----|----|----|------|----|----|
|    |    | 陽性 | 判定保留 | 陰性 |    |
| 新法 | 陽性 | 49 | 0    | 1  | 50 |
|    | 陰性 | 5  | 4    | 39 | 48 |
| 計  |    | 54 | 4    | 40 | 98 |

陽性一致率：90.7%  
陰性一致率：97.7%  
判定一致率：93.9%  
(判定保留を陰性とした場合の一致率)

(社内検討データ)