

先生各位

検査内容変更のご案内①

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査受託中止および検査内容を変更させていただきますご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

■最終受付日 平成 26年3月29日(土)ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	受託中止理由
85	4529・4530 4Z260	サイクリックGMP(c-GMP)	検査試薬販売中止のため
141	2278 5G513	抗フォスファチジルセリンIgG抗体	平成23年2月26日ご依頼分より一時受託中止と させていただいておりましたが、この度試薬の 製造が中止となったため
	2279 5G513	抗フォスファチジルセリンIgM抗体	

■実施日 平成 26年3月29日(土)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
94	3093 2B200	アンチトロンビンⅢ定量	検査項目名称	アンチトロンビン抗原	アンチトロンビンⅢ定量	測定委託先 による変更
			基準値	23.6～33.5mg/dL	17.0～30.0mg/dL	

■実施日 平成 26年3月31日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容



案内書	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
45	9504 3M532	テイコプラニン	基準値	Trough 10～30μ g/mL	管理目標値 Trough 5～10μ g/mL	測定委 託先 による変 更
46	9650 3M805	シクロスポリン	採取量(mL)	0.7	1	
			検査方法	ECLIA	RIA(2抗体法)	
46	9505 3M810	タクロリムス	採取量(mL)	0.7	0.5	
			検査方法	ECLIA	ELISA	
68	2242 5G026	抗ss-DNA IgG抗体	検査方法	CLEIA	EIA	
			基準値	25.0AU/mL以下	25AU/mL以下	
			報告桁数	小数1位	整数	
			報告下限値	2.0AU/mL未満	5AU/mL未満	
			所要日数	4～5日	4～6日	
68	2244 5G036	抗ds-DNA IgG抗体	検査方法	CLEIA	EIA	
			基準値	12.0IU/mL以下	12IU/mL以下	
			報告桁数	小数1位	整数	
			報告下限値	1.2IU/mL未満	7IU/mL未満	
			所要日数	4～5日	4～6日	
85	4508 4Z270	HANP (心房性Na利尿ペプチド)	必要量(mL)	血漿 0.3	血漿 0.5	
			検査方法	FEIA	CLEIA	

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。


裏面もご確認下さい。

案内書	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
89	5396 5D415	癌関連ガラクトース 転移酵素(GAT)	所要日数	4～10日	4～6日	測定委託先 による変更

《新旧二法の相関》

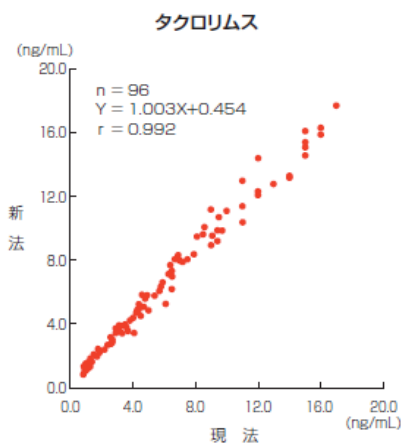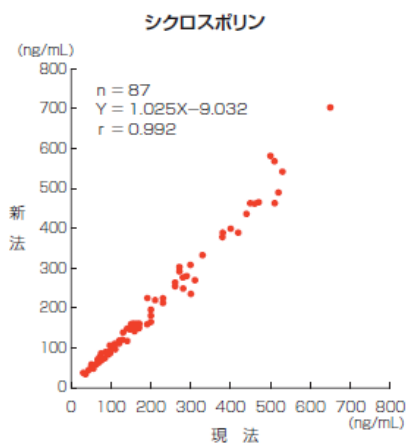

【抗ss DNA抗体-IgG】

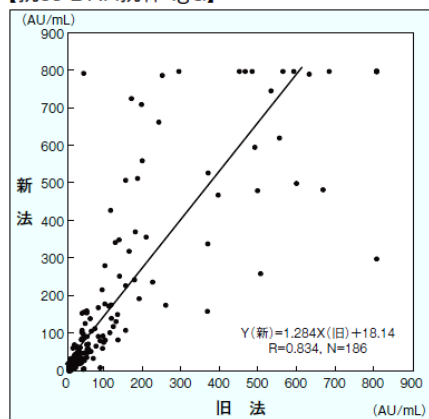


判定一致率

		旧法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	101	15	116
	陰性	7	63	70
計		108	78	186

陽性一致率：93.5%
陰性一致率：80.8%
判定一致率：88.2%

(社内検討データ)

【抗ds DNA抗体-IgG】

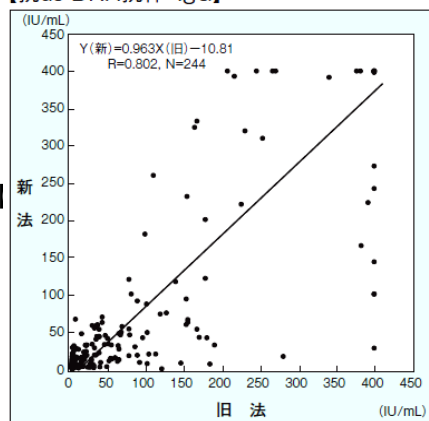


判定一致率

		旧法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	102	21	123
	陰性	25	96	121
計		127	117	244

陽性一致率：80.3%
陰性一致率：82.1%
判定一致率：81.1%

(社内検討データ)

[全体]

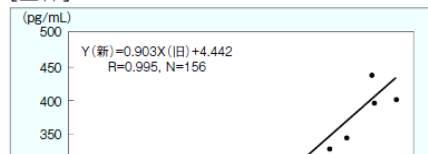

[低値域]

