

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記


■実施日

平成 29年 1月 4日(水)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
67	2516 5G085	抗Scl-70抗体	報告上限値 報告下限値	240.0 U/mL以上 0.6 U/mL未満	320.0 U/mL以上 0.5 U/mL未満	改良試薬への変更

* 報告範囲以外の変更はございません。

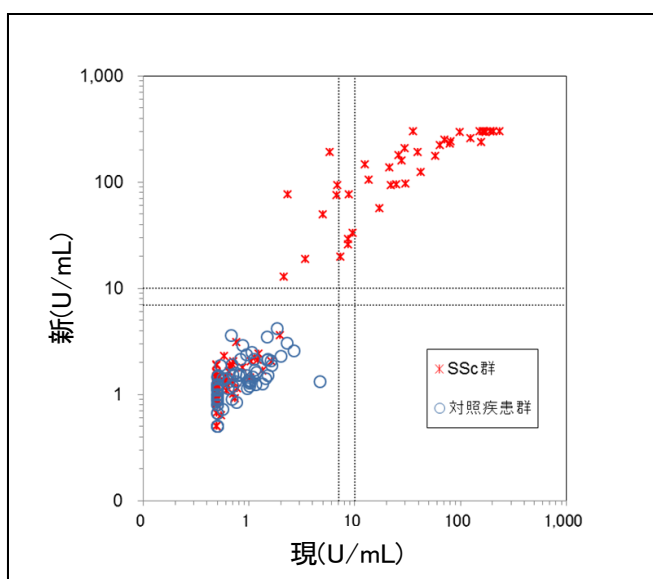

		現			合計
		(-)	(±)	(+)	
新	(-)	131	0	0	131
	(±)	0	0	0	0
	(+)	7	5	29	41
合計		138	5	29	172

陰性一致率: 94.9%

陽性一致率: 100.0%

全体一致率: 95.8%

(メーカー検討資料)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。