

採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、採取容器を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記



■実施日 平成 29年 11月 1日(水)ご依頼分より随時

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	変更箇所	新	現	備考
54 55 211 213	2435 5E021	クラミジア・トラコマチス 核酸同定	ぬぐい液	採取容器	PCR法 専用容器(細) (容器番号33) (容器番号56) [裏面参照]	PCR法 専用容器 (容器番号33) (容器番号56) [裏面参照]	容器サイズの変更 容器デザインの変更 スワブ構成の変更
	2437 5E021		尿				
	2440 5E021		うがい液				
	2436 6B610	淋菌核酸同定	ぬぐい液				
	2438 6B610		尿				
	2419 6B610		うがい液				
	2482 6B615	淋菌及びクラミジアトラコマ チス同時核酸同定	ぬぐい液				
	2483 6B615		尿				
	2420 6B615		うがい液				

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■採取容器の変更

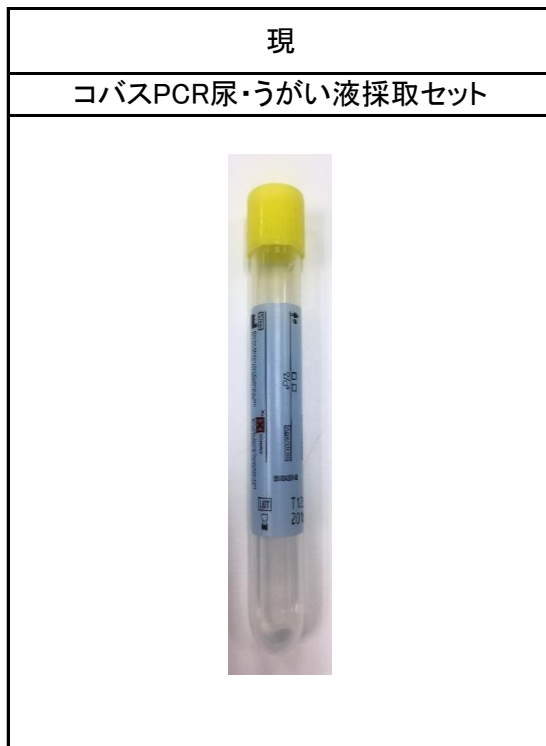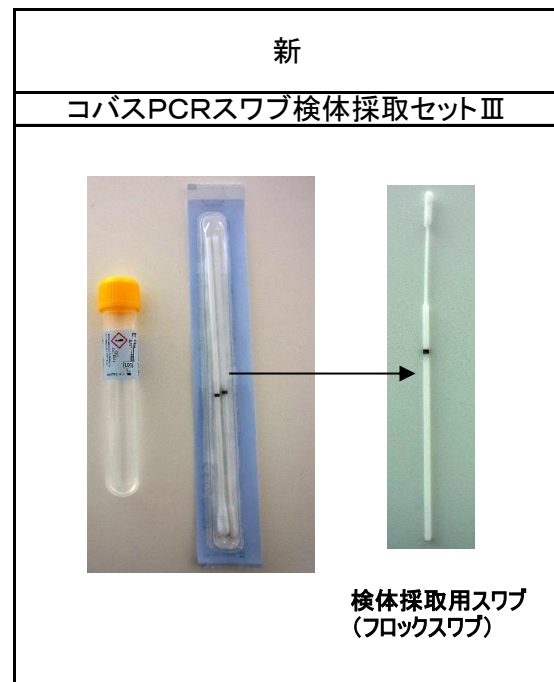

*メディア液の組成・内容量、ご使用上の運用方法に変更はございませんので、今までと変わらずご使用ください。