

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容及び微生物検査報告書の表記内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日

2023年 4月 1日（土）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
30・193	1001 3A010	血清総蛋白(TP)	測定試薬	現行試薬販売終了に伴い、別メーカー試薬に変更。		測定試薬変更のため
			備考	立位および運動により上昇する場合があります。	立位および運動により上昇する場合があります。溶血により上昇します。	
			コメント影響マーク付加項目	削除 ※共存物質の影響を受けにくくなっています	混濁(2+)、溶血(2+)よりマーク付記	
89	4104 4B015	遊離トリヨードサイロニン(FT ₃)	測定試薬	現行試薬販売終了に伴い、新試薬に変更。検査要綱は変更はありません。		
130	9356 5F432	ムンプスウイルスIgG	測定試薬	現行試薬販売終了に伴い、同一メーカー販売の改良試薬に測定変更。		
			備考	(削除)	注2) 髄液の測定も可能です 検体量0.4mL(冷蔵) 基準値0.20未満 陰性	
134	9453 5F560	HIV抗原・抗体 《スクリーニング》	報告形式	通常報告 ※電子媒体による結果表示が可能です。	親展扱い	見直しのため

■実施日

2023年 4月 1日（土）ご報告分より

■報告菌名の表記内容変更


新 菌名表記	現 菌名表記
<i>Klebsiella aerogenes</i>	<i>Enterobacter aerogenes</i>

裏面もご確認下さい


ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。

<新旧の相関>


〔血清総蛋白〕



〔遊離トリヨードサイロニン(FT3)〕

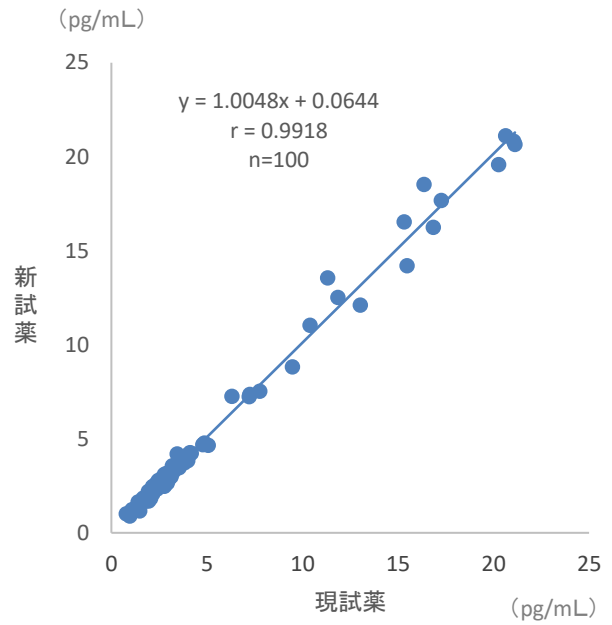

〔ムンプスウイルスIgG〕



判定一致表		現試薬			合計
		+	±	-	
新試薬	+	18	13	1	32
	±	0	4	1	5
	-	0	1	8	9
合計		18	18	10	46

陽性一致率: 100%
陰性一致率: 80%
全体一致率: 65%
(内部検討資料より)