

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2025年 4月 1日(火)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
33	1612 3B015	CK-MB(CPK-MB) [CLIA]	基準値	5.0 ng/mL 未満	5.0 ng/mL 以下	改良試薬への変更のため。
			報告下限	0.2 ng/mL 未満	1.0 ng/mL 以下	


* CK-MBは国際標準化機構(ISO)の国際標準規格(ISO 15189)が無く、独自の標準品で校正した製品を提供しており各試薬メーカーにより値に差異が生じていました。しかし、各メーカー間の協調(ハーモナイゼーション)により各々の値を是正する事となり、今回、値付けを変更した試薬へ変更させていただきます。

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	備考
90	4147 4C025	副甲状腺ホルモン-intact (PTH-intact)	測定試薬	改良試薬(血中ビオチンの影響が軽減された製品)への変更のため。
99	4360 5D130	CA19-9		改良試薬への変更のため。

* 上記以外の変更点はございません。

■相関図

[CK-MB(CPK-MB)[CLIA]]

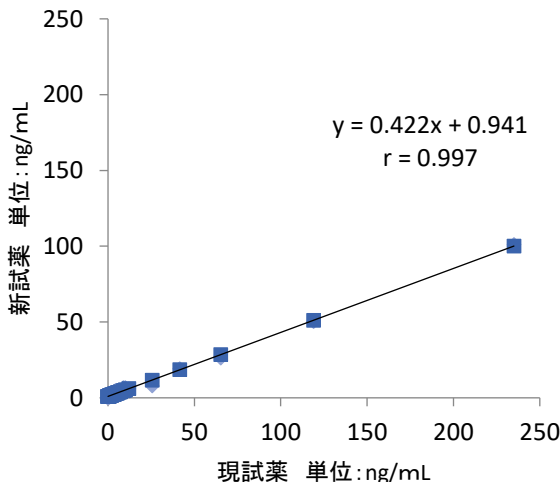


(社内検討資料より)

裏面もご確認ください

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■ 相関図

[副甲状腺ホルモン-intact (PTH-intact)]

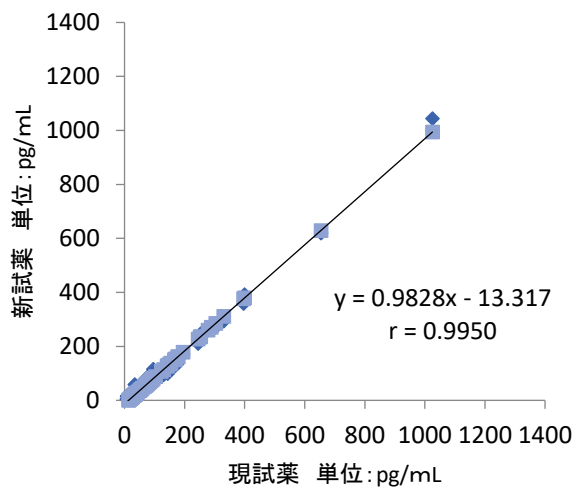

[CA19-9]

